


 *Rayos X Dinan*

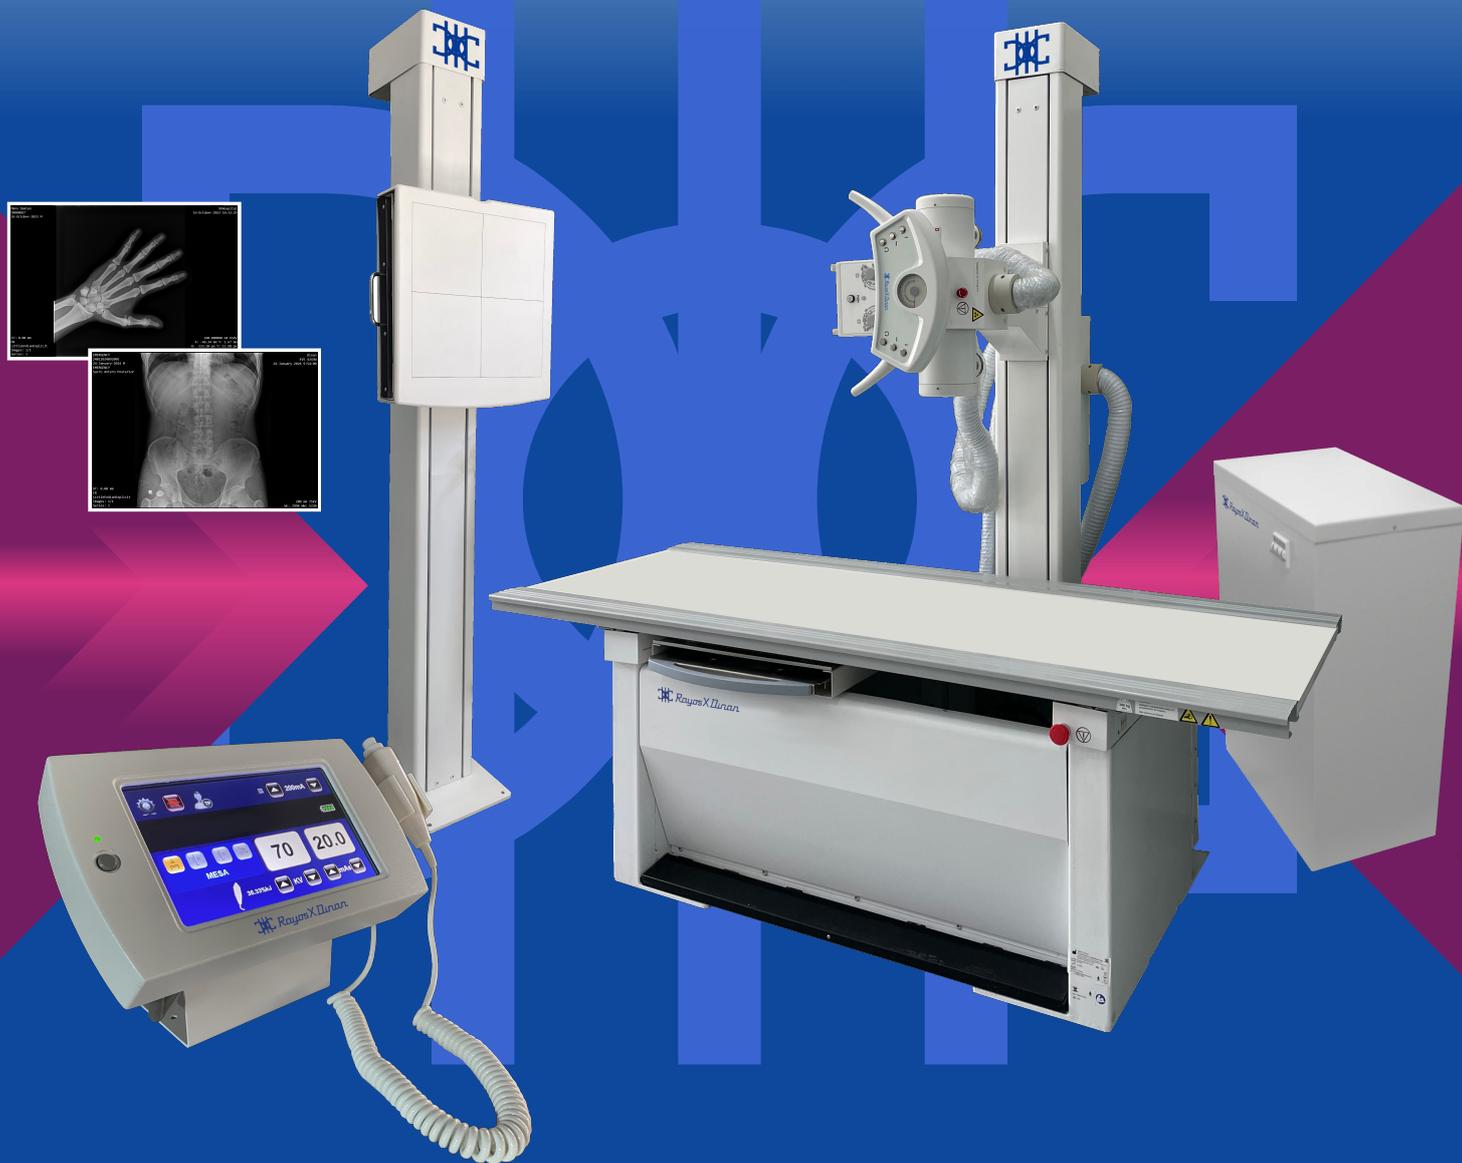

Dinar AF-500

PUESTO FIJO CON COMANDO DIGITAL

Equipamiento radiológico de alta frecuencia

www.rayosxdinan.com.ar

Dinar AF-500

PUESTO FIJO CON COMANDO DIGITAL Equipamiento radiológico de alta frecuencia

- Estabilización automática de tensión de línea.
- Controlado por microprocesador.
- Pantalla touchscreen 7" full color.
- Indicación en pantalla de KV, mA, ms y mAs.
- Comutación automática de focos según el tubo utilizado.
- Señalización acústica e indicación en pantalla de preparación, emisión de rayos X y bloqueos de seguridad.
- Arrancador de ánodo: impulso rápido y régimen sub-alimentado.
- Control e indicación de carga térmica acumulada en el tubo.
- Técnicas radiológicas programables: posibilidad de re-programación por el usuario.

Alimentación:

- Estandar 3x380V 50/60Hz Trifásica
- Opcional 3x220V 50/60Hz Trifásica



Columna:

Deslizable sobre rieles piso-techo, gira sobre el eje vertical. Movimientos suaves con rotación de 180°. Frenos eletromagnéticos de baja tensión comandados desde el panel de control con interruptores iluminados. Sistema de seguridad por descarrilamiento y rotura de cable de acero.



Potter-Bucky Mural:

Bandeja autocentrante de acero inoxidable con freno eletromagnético.



Opcional:

Sistema de digitalización de imágenes.



Mesa con camilla desplazable:

Movimiento longitudinal y lateral. Potter-Bucky con bandeja autocentrante de acero inoxidable y freno eletromagnético.

